



PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD PEEC-EA | SALUD OCUPACIONAL

# SUBPROGRAMA: PLOMO EN SANGRE

INFORME ENSAYO DE APTITUD | SALUD OCUPACIONAL | RONDA 21-04-AÑO: 2021 VERSIÓN:00



## INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL  
SUBDEPARTAMENTO DE AMBIENTES LABORALES  
SECCIÓN LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA OCUPACIONAL

Av. Marathon 1000, Ñuñoa. Santiago. Chile.  
Código Postal 7780050.

[www.ispch.cl](http://www.ispch.cl)

### Coordinadora PEEC-EA:

KAREN ESPINOZA DONOSO

### Revisor:

NARIA OYANEDEL GIAVERINI

### Autorizado por:

Jefe Departamento Salud Ocupacional  
PATRICIO MIRANDA ASTORGA

### Informe Ronda 21-04 - Año: 2021

Fecha: 08/11/21

Versión N°: 00

### Contacto:

Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS)

Lunes a Jueves de 08:00 a 17:30 horas

Viernes de 08:00 a 16:30 horas

Fono: +56 2 25755600 – +56 2 25755601

<http://www.ispch.cl/oirs/>



## CONTENIDO.

<b>1.</b>	LISTA DE LABORATORIOS PARTICIPANTES, AÑO 2021.....	<b>4</b>
<b>2.</b>	RESPONSABLES.....	<b>5</b>
<b>3.</b>	INTRODUCCIÓN.....	<b>5</b>
<b>4.</b>	MATERIAL DE ENSAYO.....	<b>5</b>
<b>5.</b>	PROGRAMACIÓN 2021.....	<b>6</b>
<b>6.</b>	ANÁLISIS ESTADÍSTICO.....	<b>6</b>
<b>6.1.</b>	Valor Z.....	<b>6</b>
<b>6.2.</b>	Clasificación Valor Z.....	<b>7</b>
<b>7.</b>	CALIFICACIÓN DE PROFICIENCIA O DE BUEN DESEMPEÑO.....	<b>8</b>
<b>7.1.</b>	Proficiencia.....	<b>8</b>
<b>7.2.</b>	Rendimiento.....	<b>8</b>
<b>7.3.</b>	Calificación de la Ronda.....	<b>8</b>
<b>8.</b>	RESULTADOS INFORMADOS POR LOS PARTICIPANTES.....	<b>9</b>
<b>8.1.</b>	Universo de Datos.....	<b>9</b>
<b>8.2.</b>	Método Analítico.....	<b>9</b>
<b>8.3.</b>	Técnica Analítica.....	<b>9</b>
<b>8.4.</b>	Gráfica de Distribución de Valor Z.....	<b>9</b>
<b>8.5.</b>	Tendencia por Laboratorio.....	<b>10</b>
<b>8.6.</b>	Clasificación Valor Z.....	<b>11</b>
<b>8.7.</b>	Calificación de Proficiencia (Buen Desempeño).....	<b>12</b>
<b>9.</b>	TERMINOLOGÍA.....	<b>13</b>
<b>10.</b>	REFERENCIAS.....	<b>13</b>
<b>11.</b>	ANEXOS.....	<b>14</b>

## 1. LISTA DE LABORATORIOS PARTICIPANTES, AÑO 2021.

DICTUC S.A	CIUDAD SANTIAGO
LABORATORIO DE HIGIENE INDUSTRIAL – ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD	CIUDAD SANTIAGO
LABORATORIO DE HIGIENE INDUSTRIAL – INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO	CIUDAD VIÑA DEL MAR
LABORATORIO DE SALUD OCUPACIONAL CESMEC S.A.	CIUDAD SANTIAGO
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA AMBIENTAL Y LABORAL	CIUDAD ARICA
LABORATORIO LIVIO BARNAFI S.A	CIUDAD SANTIAGO
SALUD Y SEGURIDAD QUÍMICA EN EL TRABAJO	CIUDAD SANTIAGO

## 2. RESPONSABLES.

### Coordinación y ejecución:

Ing. Karen Espinoza Donoso  
Email contacto: peec-eaocupacional@ispch.cl

## 3. INTRODUCCIÓN.

El Instituto de Salud Pública de Chile, en cumplimiento de su función de laboratorio de referencia nacional, tiene la misión de asegurar la calidad y consistencia de los resultados entregados por los laboratorios del área de la salud.

De esta forma, el Departamento de Salud Ocupacional del Instituto de Salud Pública de Chile, organiza programas de evaluación externa de la calidad (PEEC) para normalizar la calidad de los resultados emitidos por los laboratorios participantes. Los resultados de estos ensayos permiten a los laboratorios de Salud Ocupacional, evaluar su aptitud al momento de realizar las mediciones, y también su evolución, al analizar la información recopilada en el tiempo.

La información provista, permite a los laboratorios participantes tomar acciones con el fin de mantener un buen desempeño analítico, mejorando así la calidad de la evaluación de los riesgos a los que se exponen los trabajadores en el desempeño de su labor.

## 4. MATERIAL DE ENSAYO.

El material de referencia utilizado en el subprograma de Plomo en sangre declara los siguientes valores:

Muestra	Valor de Referencia (µmol/L)	Límite Inferior (µmol/L)	Límite Superior (µmol/L)
Pb2104M1	0,603	0,504	0,702
Pb2104M2	1,040	0,876	1,200

## 5. PROGRAMACIÓN.

Actividad	Fecha
Envío MR	05/10/21
Fecha límite recepción de resultados	22/10/21
Entrega resultados en sistema	29/10/21
Envío Informe Ronda	08/11/21
Período Observaciones	09/11/21 – 12/11/21
Publicación Web (a partir de)	15/11/21

## 6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO.

### 6.1. Valor Z.

El parámetro “Z” describe en qué medida los resultados informados por los laboratorios se alejan del valor de referencia asignado al material analizado.

Este valor es adimensional e indica cuántas desviaciones estándares separan el valor informado por el participante, del valor de referencia. Se calcula de acuerdo a la siguiente expresión:

$$Z = \frac{(X - \mu)}{\sigma}$$

#### Dónde;


**X** : es el valor informado por el laboratorio participante.

**μ** : es el valor de referencia asignado.

**σ** : es la desviación estándar del valor de referencia.

## 6.2. Clasificación Valor Z.

Los criterios de aceptabilidad, están definidos por el valor obtenido por cada laboratorio, y son clasificados de la siguiente manera:

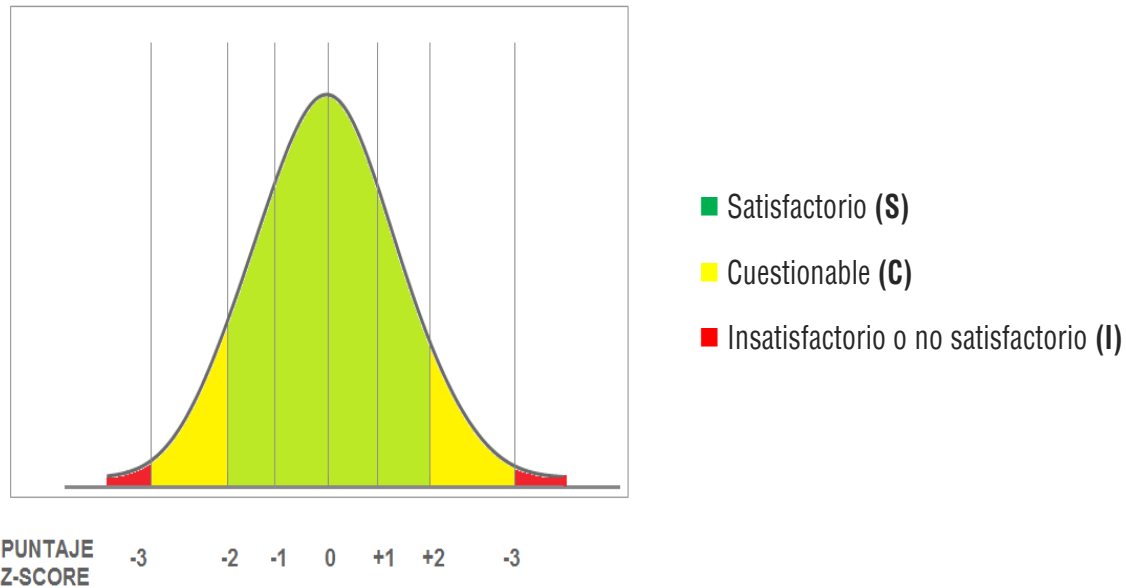

$|Z| \leq 2,00$  : es decir, entre -2,00 y +2,00 el desempeño es **Satisfactorio**.

$2,00 < |Z| \leq 3,00$ : entre -2,01 y -3,00 y; entre +2,01 y +3,00 el desempeño es **Cuestionable**.

$|Z| > 3,00$  : el resultado del laboratorio es **Insatisfactorio**, es decir no satisfactorio.

Para fines de conservar la confidencialidad de los resultados y la evaluación de desempeño de los participantes, estos son reportados en el informe con el código CIL (Código de Identificación del Laboratorio), por lo cual el participante deberá ubicarse en las tablas y gráficas de acuerdo con el código CIL asignado a su laboratorio para el año correspondiente de la presente ronda.

## 7. CALIFICACIÓN DE PROFICIENCIA O DE BUEN DESEMPEÑO.

Con el fin de mejorar la información que se entrega a los participantes como parte del análisis de los resultados por ronda, se entrega la calificación de rendimiento de la ronda y la de Proficiencia.

### 7.1. Proficiencia.

Se clasificará como **Proficiente (P)** cuando al menos 6 resultados de 8, informados de manera consecutiva, estén dentro del rango de valores satisfactorios ( $-2,00 \leq Z \leq 2,00$ ).

**No Proficiente (NP).** Por defecto de la definición anterior, un laboratorio será clasificado como “no proficiente” cuando no reúna el criterio anterior.

### 7.2. Rendimiento.

Razón de valores **Z** satisfactorios alcanzados,

$$\text{Rendimiento} = \frac{\text{Nº de valores z en rango aceptable}}{\text{Nº de muestras de la ronda}}$$

**Dónde;**

**Numerador:** corresponde al número de valores Z en el rango de valores verdaderos ( $-2,00 \leq Z \leq 2,00$ ).

**Denominador:** número total de muestras enviadas en la ronda.

### 7.3. Calificación de la ronda.

**Aceptable (A):** corresponde al 75% o más valores Z dentro del rango de valores verdaderos ( $-2,00 \leq Z \leq 2,00$ ).

**No aceptable (NA):** más de 25% de valores Z fuera del rango de valores verdaderos ( $Z < -2,00$  ó  $Z > 2,00$ ).



## 8. RESULTADOS INFORMADOS POR LOS PARTICIPANTES.

### 8.1. Universo de datos.

**Ronda 21-04.** La ronda fue adscrita por 7 laboratorios, de los cuales 6 remiten resultados. Los valores reportados son incluidos en la sección Anexo, Tabla 1.

### 8.2. Método analítico.

En esta ronda no se recopiló información de los métodos analíticos utilizados.


### 8.3. Técnica analítica.

4 de los laboratorios declaran utilizar Espectrofotometría de Absorción atómica, en modalidad horno de grafito y 2 laboratorios ICP-MS.

### 8.4. Gráfica de distribución de valor Z.

La estandarización de los valores reportados por los laboratorios participantes para las muestras de la ronda, es presentada a continuación en la gráfica de barras. Los datos de origen, son incluidos en la sección Anexos, tabla 1.

#### Ronda 21-04






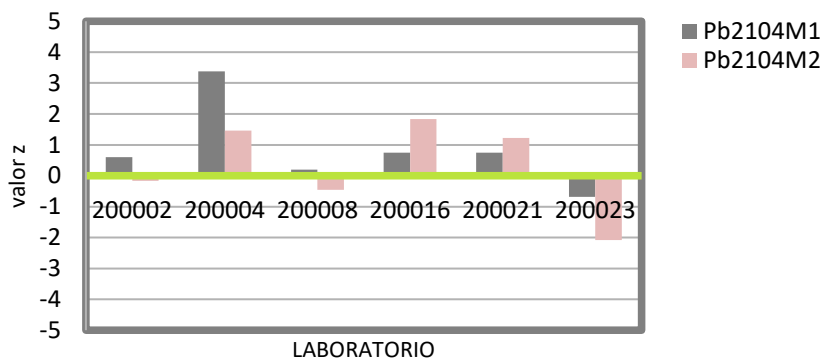


#### Comentario.

La gráfica de valores Z presenta que para la muestra Pb2104M1, 5 laboratorios informan valores en el rango satisfactorio y 1 laboratorio informa un valor insatisfactorio. Para la muestra Pb2104M2, 5 laboratorios informan valores en el rango satisfactorio y 1 laboratorio informa un valor cuestionable.

### 8.5. Tendencias por laboratorio.

Con el fin de determinar las variaciones en el tiempo de los resultados de cada laboratorio, se muestran los gráficos de tendencia en los resultados de las últimas cuatro rondas.

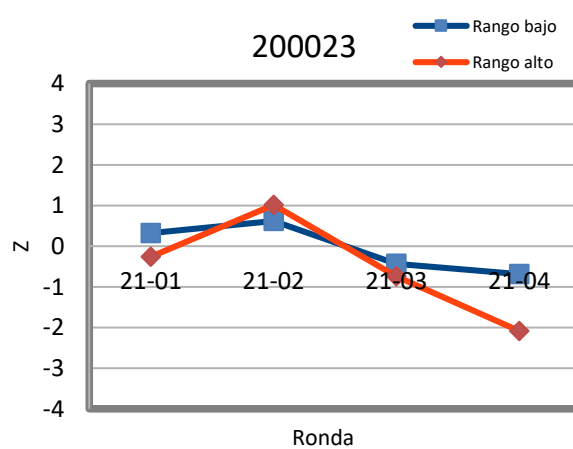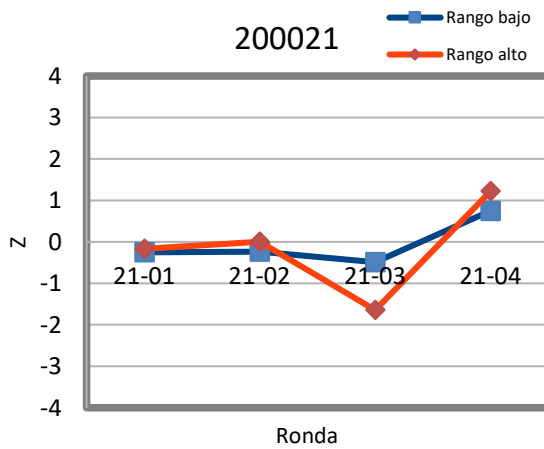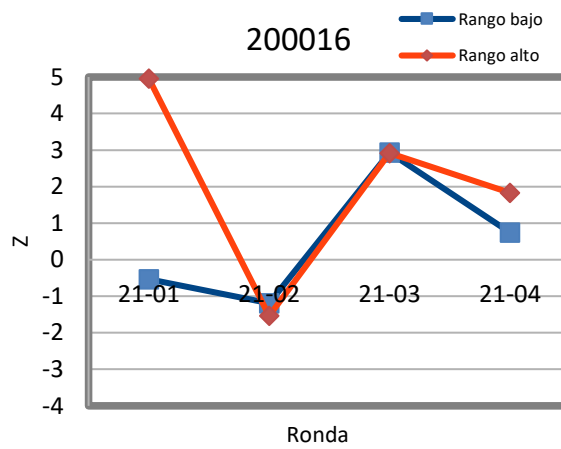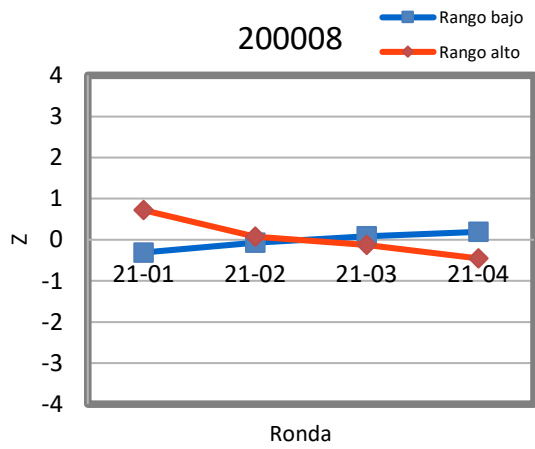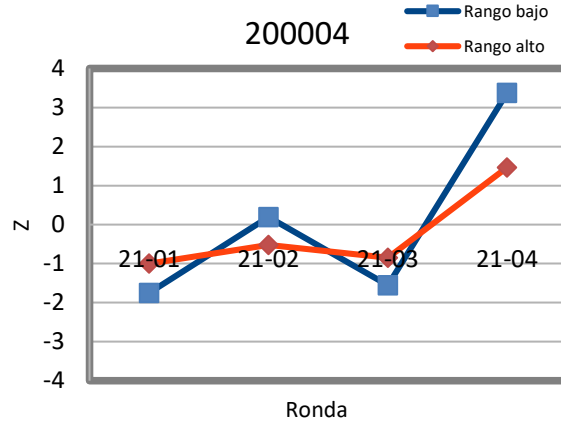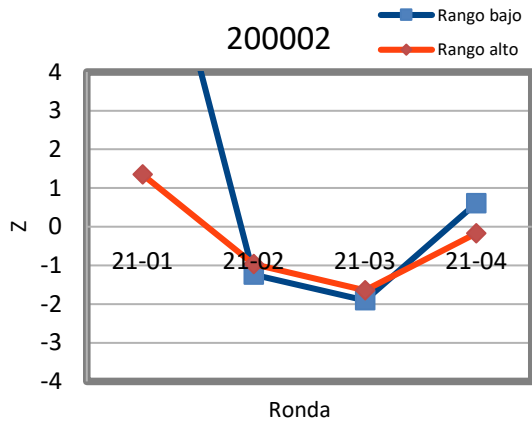

## 8.6. Clasificación valor Z.

Resumen de la clasificación alcanzada por cada laboratorio, para cada muestra control informada.

Laboratorio	Clasificación valor Z	
	Pb2104M1	Pb2104M2
200002	S	S
200004	IS	S
200008	S	S
200016	S	S
200018	NI	NI
200021	S	S
200023	S	Q

**S:** satisfactorio; **Q:** cuestionable; **IS:** insatisfactorio; **NI:** no informa

## 8.7. Calificación de Proficiencia (buen desempeño).

Resumen de la calificación alcanzada por cada laboratorio, junto con cada muestra control informada, correspondiente a la ronda 21-04.

Código	ID Ronda	Rendimiento	Clasificación Ronda	Proficiencia
200002	2021-Envío 1	1/2	NA	P
	2021-Envío 2	2/2	A	
	2021-Envío 3	2/2	A	
	2021-Envío 4	2/2	A	
200004	2021-Envío 1	2/2	A	P
	2021-Envío 2	2/2	A	
	2021-Envío 3	2/2	A	
	2021-Envío 4	1/2	NA	
200008	2021-Envío 1	2/2	A	P
	2021-Envío 2	2/2	A	
	2021-Envío 3	2/2	A	
	2021-Envío 3	2/2	A	

<b>200016</b>	2021-Envío 1	1/2	NA	<b>NP</b>
	2021-Envío 2	2/2	A	
	2021-Envío 3	0/2	NA	
	2021-Envío 4	2/2	A	
<b>200018</b>	2021-Envío 1	2/2	A	<b>P</b>
	2021-Envío 2	2/2	A	
	2021-Envío 3	2/2	A	
	2021-Envío 4	0/2	NA	
<b>200021</b>	2021-Envío 1	2/2	A	<b>P</b>
	2021-Envío 2	2/2	A	
	2021-Envío 3	2/2	A	
	2021-Envío 4	2/2	A	
<b>200023</b>	2021-Envío 1	2/2	A	<b>P</b>
	2021-Envío 2	2/2	A	
	2021-Envío 3	2/2	A	
	2021-Envío 4	1/2	NA	

### **Comentario.**

Al término de la ronda 21-04, 6 de los 7 laboratorios participantes alcanzan una calificación de “Proficiente”, ya que reúnen como mínimo 6 resultados dentro del valor Z verdadero, es decir cumple con un 75% de muestras aceptables para alcanzar con dicha categoría.

## 9. TERMINOLOGÍA.

**Valor de referencia:** valor asignado al material de referencia.

**Rango de referencia:** rango de valores informados por el material de referencias.

## 10. REFERENCIAS.

1. ISO/IEC 17043 CONFORMITY ASSESSMENT GENERAL REQUIREMENTS FOR PROFICIENCY TESTING. 2010.
2. ESTADÍSTICA Y QUIMIOMETRÍA PARA QUÍMICA ANALÍTICA. James Miller y Jane Miller. 4° Edición.
3. Bases Técnicas de los Ensayos de Aptitud. Laboratorio de Salud Ocupacional, Instituto de Salud Pública de Chile.
4. Bases Generales PEEC-EA. Laboratorio de Salud Ocupacional, Instituto de Salud Pública de Chile.
5. Decreto Supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.

## 11. ANEXOS.

**Tabla N° 1:** Valores informados.

Código Laboratorio	Muestra	Informado (µmol/L)	Z
200002	Pb2104M1	0,633	0,61
	Pb2104M2	1,026	-0,17
200004	Pb2104M1	0,77	3,37
	Pb2104M2	1,16	1,48
200008	Pb2104M1	0,6125	0,19
	Pb2104M2	1,0028	-0,46
200016	Pb2104M1	0,64	0,75
	Pb2104M2	1,19	1,85
200018	Pb2104M1	-	-
	Pb2104M2	-	-
200021	Pb2104M1	0,64	0,75
	Pb2104M2	1,14	1,23
200023	Pb2104M1	0,569	-0,69
	Pb2104M2	0,869	-2,11

**Tabla N° 2:** Valores de referencia.

Muestra	Valor de Referencia (µmol/L)	Límite inferior (µmol/L)	Límite superior (µmol/L)
Pb2104M1	0,603	0,504	0,702
Pb2104M2	1,040	0,876	1,200

**Tabla N° 3:** Valores y dispersión de valores informados.

Muestra	Promedio Ronda (µmol/L)	SD Ronda (µmol/L)
Pb2104M1	0,644	0,067
Pb2104M2	1,065	0,122